

T-COR 8™

Guia de Início Rápido

PLM-0663-3

Data de emissão: 2024/06

Nº. de Catálogo: TC-3004-001 (quatro canais), TC-3013-001 (cinco canais), TC-3019-001 (cinco canais com bateria substituível pelo utilizador), TC-3010-001 (misturador magnético)

Índice do Conteúdo

COMO USAR ESTE GUIA	4
PROPÓSITO DESTE GUIA	4
CONVENÇÕES DE TEXTO	4
DOCUMENTAÇÃO RELACIONADA	5
DEFINIÇÃO DOS SÍMBOLOS	6
COMO OBTER MAIS INFORMAÇÕES	9
INFORMAÇÕES DE CONTACTO	9
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES	10
RELATAR UM INCIDENTE GRAVE	10
USO PRETENDIDO	11
VERSÕES DE SOFTWARE APLICÁVEIS	11
DESEMBALAGEM E ACESSÓRIOS	12
PRODUTOS CONSUMÍVEIS NECESSÁRIOS (NÃO FORNECIDOS)	14
REQUISITOS DE INSTALAÇÃO INICIAL	14
CONDIÇÕES AMBIENTAIS	14
LIGAR A UMA TOMADA ELÉTRICA	15
LIGAR A ENERGIA AO DISPOSITIVO	16
ACESSÓRIO MISTURADOR MAGNÉTICO	17
<i>Ligar ao T-COR 8™</i>	17
UTILIZAÇÃO DO DISPOSITIVO	18
PERSPETIVA GERAL DA UTILIZAÇÃO DO DISPOSITIVO	18
CONTAS DE UTILIZADORES PRÉ-INSTALADAS	18
MODO AUTÓNOMO	19
MODO DE LIGAÇÃO DIRETA	20
MODO DE LIGAÇÃO AO PONTO DE ACESSO	21
MODO DE LIGAÇÃO A UMA REDE	23
UM GUIA RÁPIDO PARA FAZER A CONFIGURAÇÃO	24
CRIAR UMA NOVA EXECUÇÃO (CORRIDA)	25
ÍNDICE	29

Como usar este guia

Propósito deste guia

O *Guia de Início Rápido para o T-COR 8™* proporciona a informação básica necessária para a operação do T-COR 8™. Este guia assume que o utilizador:

- Está familiarizado com o uso do navegador da web Google Chrome™.
- Tem um entendimento geral de discos rígidos (hard drives) e de armazenagem de dados, transferência de ficheiros, e cópia e inserção.



Antes de operar o T-COR 8™, reveja as informações no *Manual de Hardware Tetracore T-COR 8™* (PLM-0662) e no *Manual de Software Tetracore T-COR 8™* (PLM-0664).

Convenções de texto

Este guia utiliza as seguintes convenções:

- Texto em **negrito** indica uma etiqueta. Por exemplo, o título duma página ou duma caixa de texto.
- Texto em [Parênteses retos] indica um botão. Por exemplo: Prima o botão [Iniciar Corrida].
- Texto sublinhado indica importância realçada. Por exemplo: Para evitar perda de dados, nunca desligue o T-COR 8™ até que todas as corridas tenham sido completadas.
- Texto em *itálico* indica uma referência a outras informações adicionais. Por exemplo: Consulte *Perigo para a Segurança Física*.

Documentação relacionada





Versões em cópia eletrônica dos manuais na lista da Tabela 0-1 estão disponíveis na interface do utilizador do software T-COR 8™. Os manuais podem ser acedidos a partir do navegador da web de um dispositivo externo e não estão disponíveis no modo Autónomo. Os manuais podem ser abertos navegando até [Menu], abrindo [Informações] e premindo o botão [Manuais].


Documento	Número de peça	Descrição
Manual de Software do T-COR 8™	PLM-0664	O <i>Manual de Software do Tetracore T-COR 8™</i> proporciona a informação necessária para utilizar o T-COR 8™.
Manual de Hardware do T-COR 8™	PLM-0662	O <i>Manual de Hardware do Tetracore T-COR 8™</i> proporciona a informação necessária para utilizar o T-COR 8™.
Especificação de Conectividade LIS para T-COR 8™	PLM-0697	A <i>Especificação de Conectividade LIS para o T-COR 8™</i> documenta a mensagem HL7 enviada do dispositivo T-COR 8™ para um servidor LIS.

Definição dos símbolos

A tabela seguinte descreve símbolos que podem ser usados no dispositivo T-COR 8™, na sua embalagem ou na documentação associada.

Símbolo	Descrição
	Indica o fabricante do dispositivo.
	Indica o país de fabricação. A data de fabricação pode ser adicionada ao lado deste símbolo.
	Indica a entidade que está a importar o dispositivo para a localidade.
	Indica a entidade que distribui o dispositivo na localidade.
	Indica o número de série do fabricante de modo que um dispositivo específico possa ser identificado.
	Indica o número do catálogo do fabricante para que o dispositivo possa ser identificado.
	Indica o código do lote do fabricante para que o grupo ou lote possa ser identificado.
	Indica um dispositivo destinado somente para um uso único.
	Indica o número total de testes que podem ser realizados com um dispositivo.

Símbolo	Descrição
	Indica que o utilizador tem necessidade de consultar as instruções de utilização. Um indicador eIFU para a localização das instruções de utilização pode ser adicionado adjacente a este símbolo.
	Indica um dispositivo que precisa de ser protegido da humidade.
	Indica os limites de temperatura aos quais o dispositivo pode ser exposto com segurança.
	Indica um dispositivo em conformidade com toda a legislação aplicável da UE, incluindo a Diretiva 2014/35/UE para Baixa Tensão (LVD), a Diretiva 2014/30/UE para Compatibilidade Eletromagnética (EMC) e a Diretiva 2011/65/UE (versão consolidada) da União Europeia sobre a restrição do uso de certas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrónicos (RoHS). Isto inclui as alterações introduzidas pela Diretiva Delegada 2017/2102. A conformidade com a LVD 2006/95/EC e a EMCD 2004/108/EC é aplicável aos números de catálogo TC-3004-001 e TC-3013-001.
	Não se aplica ao TC-3004-001 nem ao TC-3013-001. Regulamentos de Compatibilidade Eletromagnética (2016) Regulamentos de Equipamento Elétrico (Segurança) (2016) Regulamentos de restrição do uso de certas Substâncias Perigosas em equipamentos elétricos e eletrónicos 2012 (conforme alterados) Grã-Bretanha 2022
	<u>Não descarte este produto como lixo municipal não sortido.</u> Siga a regras municipais locais de lixos para cumprir as determinações apropriadas de descarte, de modo a reduzir o impacto ambiental de Resíduos de Equipamento Elétrico e Eletrónico (WEEE). Clientes da União Europeia: Chame um representante técnico da Tetracore para a recolha e reciclagem de equipamento.
	Indica o representante autorizado na Comunidade Europeia.

Símbolo	Descrição
	<p>Norma EMC U.S.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Classe A: Este dispositivo cumpre com a Parte 15 das Regras do FCC. A operação está sujeita às seguintes duas condições: (1) Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial, e (2) este dispositivo tem que aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar operação não desejada. • Alterações ou modificações não expressamente aprovadas pelo fabricante poderão anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento. • NOTA: Este equipamento foi testado e foi determinado que cumpre com os limites para um dispositivo digital de Classe A, segundo a Parte 15 das Regras da FCC. Estes limites são concebidos para proporcionar razoável proteção contra interferência prejudicial numa instalação residencial. Este equipamento gera e pode radiar energia em frequências rádio e, se não for instalado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial a comunicações de rádio. Porém não há garantia de que uma interferência não venha a ocorrer numa instalação em particular. Se este equipamento causar interferência à receção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ligando e desligando o equipamento, o utilizador é encorajado a tentar corrigir a interferência por uma ou mais das seguintes medidas: <ul style="list-style-type: none"> ○ Reorientar ou mudar o local da antena recetora ○ Aumentar a separação entre o equipamento e o recetor ○ Ligar o equipamento a uma tomada de corrente num circuito diferente daquele ao qual o recetor está ligado <p>Consultar o concessionário ou um técnico experiente de rádio/TV para obter ajuda</p>

Como obter mais informações

Informações de contacto



Tetracore, Inc.
77 Upper Rock Cir.
Suite 600
Rockville, MD 20850-3986
Estados Unidos da
América

Tel: +1 240.268.5400
Fax: +1 240.268.1107
E-mail:
customersupport@tetracore.com
www.tetracore.com




EMERGO EUROPE
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands

Instruções de Segurança Importantes

Cumpra sempre as seguintes precauções para evitar situações perigosas e assegurar um desempenho correto do T-COR 8™.

Os seguintes símbolos encontram-se por todo o Guia de Início Rápido:

 **CUIDADO** Indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, poderá resultar em lesões menores ou moderadas para o utilizador ou danos ao equipamento.

 **AVISO** Indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, poderá resultar em lesões graves ou morte.

 **NOTA** Proporciona informações pertinentes para o uso do T-COR 8™. Leia cuidadosamente a nota antes de usar o produto.

 **IMPORTANTE!** Proporciona informações necessárias para a operação correta do T-COR 8™.

Quando estiver a ler este Guia de Início Rápido:

- Leia todas as instruções.
- Guarde todas as instruções.
- Esteja atento e siga todos os avisos.
- Siga todas as instruções.

Relatar um incidente grave

Qualquer incidente grave que tenha ocorrido em relação ao dispositivo deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro em que o utilizador esteja estabelecido.

Uso pretendido

O T-COR 8™ é um termociclador semi-automatizado em tempo real que se destina a ser usado com testes PCR, RT-PCR, isotérmico e outros testes de Amplificação de Ácido Nucleico. O T-COR 8™ mede sinais de amplificação de ácido nucleico em tempo real a partir de amostras de DNA ou de RNA transcritas reversamente, e fornece um resultado qualitativo. O T-COR 8™ não se destina ao diagnóstico humano in vitro, exceto para uso em pesquisa apenas.


 **AVISO** O T-COR 8™ é Apenas para Uso em Pesquisa. Não é para ser usado em diagnósticos clínicos humanos.

Versões de Software Aplicáveis


Este guia é aplicável às versões do software Iona.

Desembalagem e Acessórios

Para desembalar o dispositivo, retire a fita da embalagem e desdobre os lados da caixa de embalagem



Com as tampas de espuma das extremidades ainda juntas ao dispositivo, retire o dispositivo da caixa. Uma vez retirado da caixa, puxe as tampas de espuma esquerda e direita para fora do instrumento. Retire o inserto inferior da caixa.

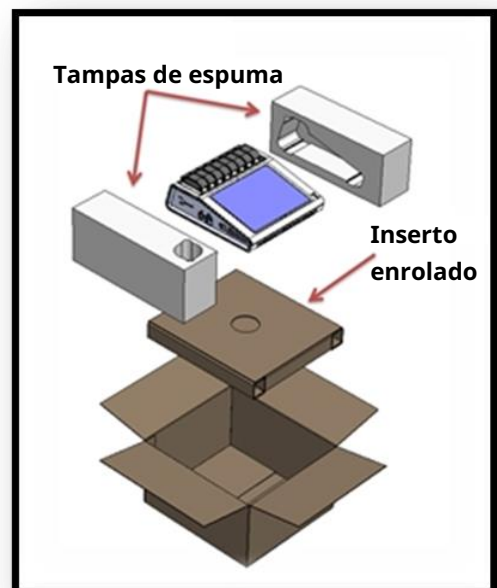

Desdobre a tampa de cima do inserto para ter acesso aos acessórios.



Verifique que estejam na embalagem os seguintes itens:

- Dispositivo T-COR 8™
- Adaptador CA
- Cabo de alimentação
- Cabo Ethernet
- Placa Rack C2T (opcional)
- Placa perfurada para tubos do T-COR 8™ (opcional)
- Misturador magnético (opcional)
- Cabo USB-A a mini-USB (opcional)



Se o dispositivo ou quaisquer acessórios estiverem em falta ou danificados, contacte a Tetracore.

⚠ CUIDADO O USB só foi concebido para uso com os acessórios recomendados da Tetracore. O uso de quaisquer acessórios USB que não sejam os recomendados pela Tetracore poderá resultar em danos ao T-COR 8™ ou ao acessório USB.

Acessível através do software a bordo do instrumento:

- Manual de Hardware
- Guia de Início Rápido
- Manual de Software
- Especificação de Conectividade LIS

Produtos Consumíveis necessários (não fornecidos)

Os tubos T-COR 8™ são necessários para usar o T-COR 8™ e não são fornecidos. O tubo T-COR é um tubo de polipropileno para uso somente com o termociclador T-COR 8™ em tempo real. É um acessório descartável de um único uso necessário para conter/armazenar amostras para uso com PCR, RT-PCR, isotérmico e outros testes de Amplificação de Ácido Nucleico. Para encomendar itens, contacte um representante da Tetracore.


Item	Número do catálogo
Tubo de Reação para T-COR 8™	TC-3006-500
Cartucho de Reação T-COR 8™	Vendido em kits Tetracore C2T

⚠ AVISO O utilizador não deveria substituir os produtos consumíveis necessários por outras opções sem que ocorram possíveis consequências de segurança e desempenho.

Requisitos de Instalação Inicial

Condições ambientais

⚠ AVISO: Perigo de Lesão Física. Use este produto apenas conforme especificado neste manual. Usar este dispositivo de uma maneira não especificada pela Tetracore poderá resultar em lesões pessoais ou danos ao dispositivo.



As condições de funcionamento necessárias são entre 0°C (32°F) e 50°C (122°F).

Assegure-se de que o dispositivo esteja colocado em cima numa superfície plana e resistente que possa suportar pelo menos 7 kg (15 libras).

⚠ CUIDADO Não obstrua um espaço de 15,24 cm (6 polegadas) a toda a volta, não empurre objetos para dentro, nem permita que se acumule poeira nas aberturas de ventilação. Não coloque o dispositivo num ambiente de baixa circulação de ar, tal como uma mala fechada, enquanto estiver a funcionar. Restringir a circulação do ar pode danificar o T-COR 8™ e/ou causar um incêndio.



Este dispositivo não é impermeável à água nem está protegido para resistir à água. Mantenha o T-COR 8™ afastado de líquidos para evitar danos ao dispositivo.

Ligar a uma Tomada Elétrica

⚠ CUIDADO O adaptador de corrente alterna só funcionará usando uma alimentação de corrente elétrica dentro dos limites 100-240 V CA e 47-63 Hz. Porém, as tomadas e fichas de corrente alterna variam conforme os países. Usar uma ficha de cabo de energia não compatível ou ligar incorretamente o cabo à tomada elétrica ou a uma faixa de alimentação poderá causar um incêndio ou danos ao equipamento.

⚠ CUIDADO Não use nenhum tipo de inversor de corrente com este dispositivo porque poderia causar incêndio ou danos ao equipamento.

⚠ CUIDADO Não use nenhum tipo de carregador de automóvel com este dispositivo porque poderia causar incêndio ou danos ao equipamento.

📌 NOTA Use apenas uma alimentação de energia de rede (por ex., tomada de parede) que possa fornecer um mínimo de 220 watts. A maior parte das energias elétricas de rede normais satisfazem este requisito.

Ligue o cabo de alimentação ao adaptador de CA antes de ligar a ficha DIN macho ao T-COR 8™. Para ligar o adaptador de corrente alterna ao T-COR 8™, alinhe o entalhe na ficha DIN macho com a marca V invertido (caret) no

dispositivo, e insira completamente dentro da ficha DIN fêmea. Para desligar a energia com segurança, desligue a ficha DIN macho no adaptador de corrente alterna da ficha DIN fêmea no dispositivo.

! **NOTA** Quando desligar o adaptador de corrente alterna do T-COR 8™, agarre a ficha e não o cabo, e puxe firmemente mas com suavidade, sem torcer, para evitar danificar o cabo e/ou a ficha.

Ligar a Energia ao Dispositivo

Prima o botão de energia para ligar e desligar o dispositivo. O anel de LED acende em volta do botão quando o dispositivo estiver ligado (energia ligada). Igualmente, o anel de LED não acende quando o dispositivo estiver desligado (energia desligada).

! **NOTA** Para evitar perda de dados, nunca desligue o T-COR 8™ até que todas as corridas exibam a mensagem “Corrida Completada”.

! **NOTA** Depois de ter desligado o dispositivo, espere pelo menos 15 segundos antes de ligar novamente a energia do dispositivo.

Acessório Misturador Magnético

O Misturador Magnético T-COR 8™ é um acessório opcional que pode ser comprado separadamente. Está projetado exclusivamente para uso com o T-COR 8™, com o Tubo de Reação T-COR 8™ e com o Cartucho de Reação da Tetracore. O Misturador Magnético é alimentado por USB e operado através do T-COR 8™.

Ligar ao T-COR 8™

Se tenciona executar qualquer ensaio que vai precisar do uso do misturador magnético, terá então que seguir este procedimento.

1. Desligue a energia ao T-COR 8™.
2. Identifique o cabo USB: Foi fornecido com o misturador um cabo Macho Tipo-A a Macho Tipo-B Mini (5 cavilhas/agulhas).
3. Ligue a extremidade Macho Tipo-B Mini (5 cavilhas) do cabo USB ao misturador magnético
4. Ligue a extremidade Macho Tipo-A do cabo USB ao T-COR 8™.



5. Ligue a energia do T-COR 8™.

! NOTA O misturador magnético tem que estar ligado ao T-COR 8™ antes de se ligar a energia do instrumento.

! NOTA O misturador magnético emitirá um som durante aproximadamente 20 segundos quando for ligado.

! CUIDADO O misturador magnético deve ser usado apenas com o T-COR 8™. O uso deste misturador com quaisquer outras máquinas poderá causar danos ao equipamento.


Utilização do Dispositivo

Perspetiva Geral da Utilização do Dispositivo

Existem quatro maneiras de usar o dispositivo T-COR 8™:

1. Modo Autónomo
2. Modo de Ligação Direta
3. Modo de Ligação ao Ponto de Acesso
4. Modo de Ligação a uma Rede

No Modo Autónomo, o ecrã táctil T-COR 8™ é usado - isto não requer um dispositivo externo (por exemplo, um computador). No modo Ligação Direta, é necessário um cabo Ethernet e um dispositivo externo com o navegador de web Google Chrome™ instalado em qualquer sistema operacional. Para o modo de Ligação de Ponto de Acesso, é necessário um dispositivo externo compatível com Wi-Fi com o navegador de web Google Chrome™ instalado em qualquer sistema operacional. Para o modo de Ligação de Rede, é necessária uma rede de qualquer tipo (com ou sem fios) e um dispositivo externo com o navegador de web Google Chrome™ instalado em qualquer sistema operacional.

 **NOTA** Ligação à internet não é necessária para ter acesso ao dispositivo.


Contas de Utilizadores Pré-instaladas

O T-COR 8™ tem duas contas de utilizadores pré-instaladas, *utilizador* e *admin*. O papel de Técnico é atribuído ao *utilizador*, e o papel de Administrador é atribuído ao *admin*. Quando o T-COR 8™ é removido da sua embalagem original, nem o *utilizador* nem o *admin* precisam duma palavra-passe. **É possível mudar a palavra-passe.** Para obter mais informações, consulte *Administração de Utilizadores* no *Manual do Software Tetracore T-COR 8™*. **Texto verde** indica cargos que têm acesso a funcionalidades específicas.


Modo Autónomo

Em Modo Autónomo, o dispositivo não precisa de um dispositivo externo (por exemplo, um computador) para se configurar ou para ver dados. O Modo Autónomo permite a portabilidade do dispositivo. O T-COR 8™ tem um ecrã táctil que usa um teclado que aparece no ecrã quando necessário. No modo Autónomo, o temporizador de ecrã não utilizado está programado para reduzir a luminosidade do ecrã automaticamente após 30 segundos (apenas quando está a ser alimentado pela bateria) o que pode ser revertido tocando simplesmente no ecrã táctil. Todos os recursos do software podem ser acedidos no Modo Autónomo, com exceção dos Relatórios, Gráficos de Temperatura, Calibragem do Ecrã Táctil, Página da Licença e Download Zip direto, que só podem ser acedidos via Google Chrome™ num dispositivo externo.

1. Instale o dispositivo numa área seca e plana.

 **CUIDADO** Não obstrua um espaço de 15,24 cm (6 polegadas) a toda a volta, não empurre objetos para dentro, nem permita que se acumule poeira nas aberturas de ventilação. Não coloque o dispositivo num ambiente de baixa circulação de ar, tal como uma mala fechada, enquanto estiver a funcionar. Restringir a circulação do ar pode danificar o T-COR 8™ e/ou causar um incêndio.

2. Ligue o dispositivo premindo o interruptor da energia localizado no painel do lado direito. Quando o anel de LED se acende em volta do botão da energia, o dispositivo está ligado.

 **NOTA** Se a luz não acender, é porque a bateria está completamente descarregada. Neste caso, faça o seguinte:

1. Prima o interruptor da energia novamente para desligar o dispositivo. Assegure-se de que o interruptor da energia esteja nivelado com o anel exterior.
2. Ligue o cabo de alimentação ao adaptador de CA antes de ligar a ficha DIN macho ao T-COR 8™.


3. Alinhe o entalhe na ficha DIN macho do adaptador de corrente alterna com a marca em V invertido (caret) que está no dispositivo, e insira completamente a ficha DIN na ficha DIN fêmea.
 4. Espere 15 segundos antes de ligar novamente a energia do dispositivo.
 5. Prima o interruptor da energia novamente para ligar o dispositivo.
-

3. O dispositivo está pronto para usar.

Modo de Ligação Direta

O modo de Ligação Direta permite que o utilizador aceda ao software do T-COR 8™ desde um computador por via do cabo de Ethernet em vez de usar o ecrã táctil do dispositivo. É necessário que o computador tenha instalado o Google Chrome™ a fim de poder aceder ao software do T-COR 8™. Todas as funcionalidades do software são acessíveis quando se usa o modo de Ligação Direta. Para aceder ao software no modo Ligação Direta:

1. Instale o dispositivo numa área seca e plana.

 **CUIDADO** Não obstrua um espaço de 15,24 cm (6 polegadas) a toda a volta, não empurre objetos para dentro, nem permita que se acumule poeira nas aberturas de ventilação. Não coloque o dispositivo num ambiente de baixa circulação de ar, tal como uma mala fechada, enquanto estiver a funcionar. Restringir a circulação do ar pode danificar o T-COR 8™ e/ou causar um incêndio.

2. Ligue uma extremidade do cabo de Ethernet numa ficha/porta de Ethernet dum computador desktop ou laptop. Ligue a outra extremidade do cabo de Ethernet na ficha/porta de Ethernet localizada no painel lateral esquerdo.
3. Ligue o dispositivo premindo o interruptor da energia localizado no painel do lado direito. Quando o anel de LED se acende em volta do botão da energia, o dispositivo está ligado.

! **NOTA** Se a luz não acender, é porque a bateria está completamente descarregada. Neste caso, faça o seguinte:

1. Prima o interruptor da energia novamente para desligar o dispositivo. Assegure-se de que o interruptor da energia esteja nivelado com o anel exterior.
2. Ligue o cabo de alimentação ao adaptador de CA antes de ligar a ficha DIN macho ao T-COR 8™.
3. Alinhe o entalhe na ficha DIN macho do adaptador de corrente alterna com a marca em V invertido (caret) que está no dispositivo, e insira completamente a ficha DIN na ficha DIN fêmea.
4. Espere 15 segundos antes de ligar novamente a energia do dispositivo.
5. Prima o interruptor da energia novamente para ligar o dispositivo.

-
4. No ecrã táctil, inicie a sessão (login) e vá para o Menu -> Wifi e Redes -> Configurações de Ethernet, e assegure-se de que o Modo de Ligação Direta está "Ligado". Aguarde até que o endereço IP do dispositivo apareça no canto inferior direito do ecrã táctil.
 5. Usando o computador ligado, abra o navegador da web Google Chrome™.
 6. Inscreva o endereço IP do dispositivo na caixa de URL do navegador.

! **NOTA** Quando estiver diretamente ligado a um computador por via do cabo de Ethernet, o endereço IP será sempre 192.168.8.2.

7. O dispositivo está pronto para usar.

Modo de Ligação ao Ponto de Acesso

O modo de Ponto de Acesso permite que o utilizador aceda ao software T-COR 8™ a partir de um dispositivo cliente Wi-Fi, como um telefone ou laptop. É necessário que o dispositivo cliente tenha instalado o Google Chrome™ a fim de poder aceder ao software do T-COR 8™. Todas as funcionalidades do software são acessíveis quando se usa o modo de Ponto de Acesso. Para aceder ao software no modo Ponto de Acesso:

1. Instale o dispositivo numa área seca e plana.

⚠ CUIDADO Não obstrua um espaço de 15,24 cm (6 polegadas) a toda a volta, não empurre objetos para dentro, nem permita que se acumule poeira nas aberturas de ventilação. Não coloque o dispositivo num ambiente de baixa circulação de ar, tal como uma mala fechada, enquanto estiver a funcionar. Restringir a circulação do ar pode danificar o T-COR 8™ e/ou causar um incêndio.

2. Ligue o dispositivo premindo o interruptor da energia localizado no painel do lado direito. Quando o anel de LED se acende em volta do botão da energia, o dispositivo está ligado.

! NOTA Se a luz não acender, é porque a bateria está completamente descarregada. Neste caso, faça o seguinte:

1. Prima o interruptor da energia novamente para desligar o dispositivo. Assegure-se de que o interruptor da energia esteja nivelado com o anel exterior.
 2. Ligue o cabo de alimentação ao adaptador de CA antes de ligar a ficha DIN macho ao T-COR 8™.
 3. Alinhe o entalhe na ficha DIN macho do adaptador de corrente alterna com a marca em V invertido (caret) que está no dispositivo, e insira completamente a ficha DIN na ficha DIN fêmea.
 4. Espere 15 segundos antes de ligar novamente a energia do dispositivo.
 5. Prima o interruptor da energia novamente para ligar o dispositivo.
-

3. No ecrã táctil, inicie a sessão (login) e vá para o Menu -> Wifi e Redes -> Mude para Modo de Ponto de Acesso
4. Usando o dispositivo cliente, ligue-se à nova rede Wi-Fi aberta. O SSID é o número de série do dispositivo. A segurança Wi-Fi não é uma opção neste momento. Abra o navegador da web Google Chrome™ no dispositivo cliente.
5. Inscreva o endereço IP sem fios do T-COR 8™ na caixa URL do navegador.

! **NOTA** Quando estiver diretamente ligado a um computador por via do modo de Ponto de Acesso, o endereço IP será sempre 192.168.8.3.

6. O dispositivo está pronto para usar.

Modo de Ligação a uma Rede

No modo de Ligação a uma Rede, o T-COR 8™ permite acesso remoto, controlo e análise de dados através de uma rede com ou sem fios. Um dispositivo externo com Google Chrome™ instalado tem que estar ligado à mesma rede que o T-COR 8™ a fim de aceder ao dispositivo. Depois de ter sido estabelecida uma ligação de rede com sucesso, o endereço IP atribuído ao T-COR 8™ será exibido no canto inferior direito do ecrã táctil. Abra o navegador e inscreva o endereço apropriado de IP na caixa de URL. Todas as funcionalidades do software são acessíveis quando se usa o modo de Ligação a uma Rede.

1. Instale o dispositivo numa área seca e plana.

! **CUIDADO** Não obstrua um espaço de 15,24 cm (6 polegadas) a toda a volta, não empurre objetos para dentro, nem permita que se acumule poeira nas aberturas de ventilação. Não coloque o dispositivo num ambiente de baixa circulação de ar, tal como uma mala fechada, enquanto estiver a funcionar. Restringir a circulação do ar pode danificar o T-COR 8™ e/ou causar um incêndio.

2. Ligue o dispositivo premindo o interruptor da energia localizado no painel do lado direito. Quando o anel de LED se acende em volta do botão da energia, o dispositivo está ligado.

3. Ligar a uma rede por via do cabo de Ethernet ou Wi-Fi:

- a. **Cabo Ethernet:** Ligue uma extremidade do cabo de Ethernet a um ponto de acesso da Internet (por exemplo, um modem ou uma ficha Ethernet de parede). Ligue a outra extremidade do cabo de Ethernet na ficha/porta de Ethernet localizada no painel lateral esquerdo.
- b. **Wi-Fi:** Prima o botão [Menu] localizado no lado inferior direito do ecrã no software. Prima o botão [Wifi e Redes] na janela. Prima

[Buscar Novamente] para buscar redes Wi-Fi disponíveis.

Selecione a rede à qual se quer ligar.

4. Usando qualquer computador ligado à mesma rede, abra o navegador de web Google Chrome™.
5. Inscreva o endereço IP do dispositivo na caixa de URL do navegador.


! NOTA O endereço de IP do dispositivo pode ser encontrado no canto inferior direito do ecrã táctil.

6. O dispositivo está pronto para usar.

Um Guia Rápido para Fazer a Configuração

As instruções abaixo são apenas uma perspetiva básica. Para obter informações detalhadas sobre cada um dos ecrãs e das funcionalidades, consulte o *Manual de Software do Tetracore T-COR 8™*.

Criar uma nova Execução (Corrida)

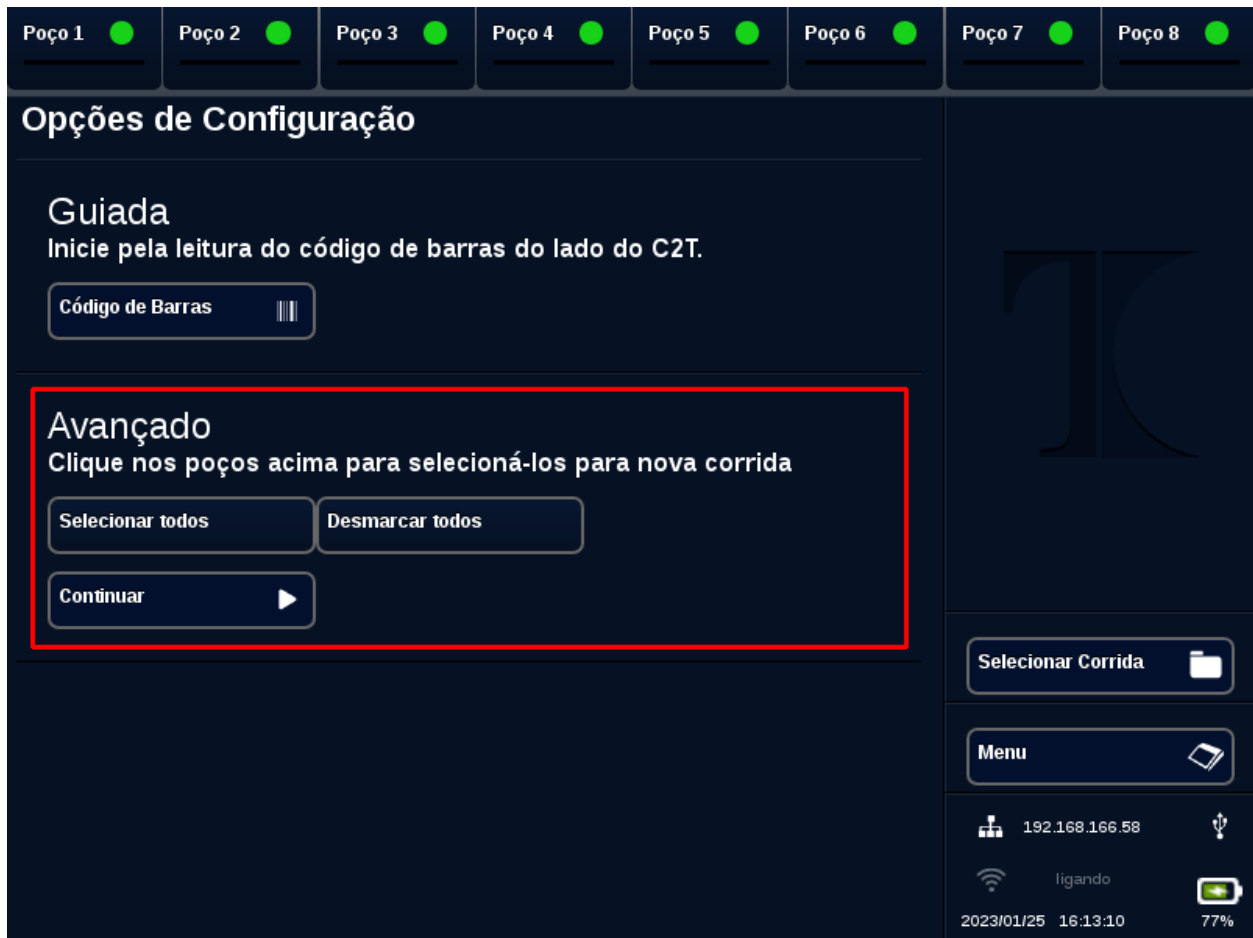

1. Inicie a sessão (sign in) no T-COR 8™
2. Abra o [Menu] e selecione [Nova Corrida].
3. Selecione os poços a ser usados, realçando o cabeçalho correspondente a cada poço. Os cabeçalhos dos poços que estão realçados terão um **círculo verde**. [Selecionar Todos] seleciona todos os poços disponíveis. [Desmarcar Todos] desmarca todos os poços.

! NOTA Quando os poços estão a funcionar atualmente, esses poços serão destacados com uma **barra vermelha**. Estes poços não estarão disponíveis até que as corridas correntes fiquem completamente terminadas.


4. Selecione [Continuar] para prosseguir para a página Resumo da Nova Corrida.



5. Insira um Nome da Corrida (opcional). Insira qualquer Comentário (opcional). Isto pode ser alterado depois da corrida ter começado, mas não pode ser alterado depois da corrida ter acabado completamente.
6. Escolha um ensaio a ser usado para esta corrida no menu suspenso abaixo de Ensaio para aplicar a todos os poços. Cada poço também pode ser atribuído com diferentes ensaios (ver passo 7).

! **NOTA** Os ensaios têm que estar já pré-definidos. Se um ensaio não estiver na lista, crie um ensaio antes de criar uma nova corrida (consulte *Editores*). **Isto só pode ser acedido pelos cargos Admin e Diretor de Laboratório.**

7. Se escolher executar mais do que um ensaio, selecione o poço com um círculo amarelo no cabeçalho do poço.

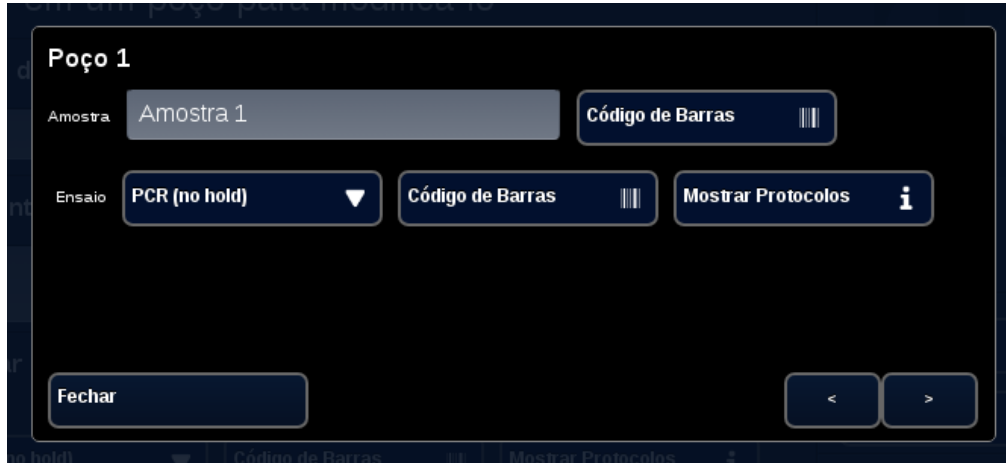

Insira o nome da Amostra para esse poço e escolha um ensaio a ser usado para este poço no menu suspenso ao lado de Ensaio. Se disponível, um ensaio também pode ser digitalizado (scanned) pressionando o botão [Código de Barras] ao lado do cabeçalho do ensaio. Prima [Fechar] para guardar em memória e sair da janela.

8. Repita o passo 7 para cada poço a ser usado na corrida.

! **NOTA** Se estiver disponível um código de barras para o ensaio, ele pode ser digitalizado (scanned) para dentro do dispositivo usando o leitor de códigos de barra localizado no painel da direita do dispositivo. Prima o botão [Código de Barras] apropriado para iniciar o leitor de código de barras (scanner). Segure bem estável o código de barras a aproximadamente 7,62 cm (3 polegadas) do scanner. O scanner de códigos de barras terminará a leitura após 10 segundos se não captar nenhuma leitura.

⚠ **AVISO: Radiação Laser.** Não olhe para o feixe de luz. Nunca aponte o laser para outras pessoas, para superfícies altamente refletoras nem para qualquer objeto que não tenha intenção de usar de uma forma designada.

9. Prima o botão [Iniciar Corrida].

Após o início da execução, o software exibirá automaticamente uma tabela de resumo das amostras e seu(s) ensaio(s). Os dados também podem ser

visualizados e analisados selecionando um determinado canal de [Gráfico] (disponível apenas para Admins, Diretores e Diretores Moleculares). As informações de Nome da Corrida, Comentários e Amostra podem ser alteradas enquanto a corrida está em curso em [Informação da Corrida]. Depois que a corrida esteja completada, o utilizador não poderá alterar as informações de Nome da Corrida, Comentários ou Amostra. Podem ser vistas corridas anteriores enquanto estejam em curso outras corridas.

Índice

A

Acessórios	12, 13
Adaptador CA.....	13, 15, 19, 21, 22
Amostras	26, 27
Aviso	10, 11, 14, 27

C

Cabo de alimentação	13, 19, 21, 22
Cabo Ethernet.....	13, 18, 20, 22, 23
Condições ambientais.....	14
Configuração	24
Contas de Utilizadores.....	18
Cuidado	10, 13, 15, 19, 20, 21, 23

D

Descarte	7
Documentação	5, 6

E

Ecrã Táctil.....	19, 20, 23, 24
Elétrico	15
Energia	15, 16, 19, 20, 21, 22, 23
Ensaio(s)	17, 26, 27
Equipamento	7, 8

G

Gráficos	19
----------------	----

I

Informações de contacto.....	9
------------------------------	---

L

LED.....	16, 19, 20, 23
Ligação ao Ponto de Acesso	21

M

Modo Autónomo	18, 19
Modo de Ligação Direta	18, 20

N

Número de série	6
-----------------------	---

P

Palavra-passe	18
---------------------	----

R

Rede	18, 23
------------	--------

S

Símbolos	6, 10
----------------	-------

T

Temperatura	7, 19
-------------------	-------

V

Versões de software	11
---------------------------	----